


V/LID	样品量 (比例)	响应 (比例)	偏差 (%)	数据文件
0.0500	0.009798	-4.20	D:\MassHunter\2020\六六六滴涕\2020-04-配液仪器验收\50-50.D	
0.1000	0.020067	-1.89	D:\MassHunter\2020\六六六滴涕\2020-04-配液仪器验收\100-100.D	
0.3000	0.058364	-4.88	D:\MassHunter\2020\六六六滴涕\2020-04-配液仪器验收\300-300.D	
0.5000	0.100412	-1.81	D:\MassHunter\2020\六六六滴涕\2020-04-配液仪器验收\500-500.D	
0.7000	0.140007	-2.21	D:\MassHunter\2020\六六六滴涕\2020-04-配液仪器验收\700-700.D	
1.0000	0.203150	-0.68	D:\MassHunter\2020\六六六滴涕\2020-04-配液仪器验收\1000-1000.D	
1.5000	0.307811	0.33	D:\MassHunter\2020\六六六滴涕\2020-04-配液仪器验收\1500-1500.D	
2.0000	0.411061	0.49	D:\MassHunter\2020\六六六滴涕\2020-04-配液仪器验收\2000-2000.D	

四氯间二甲苯 SS

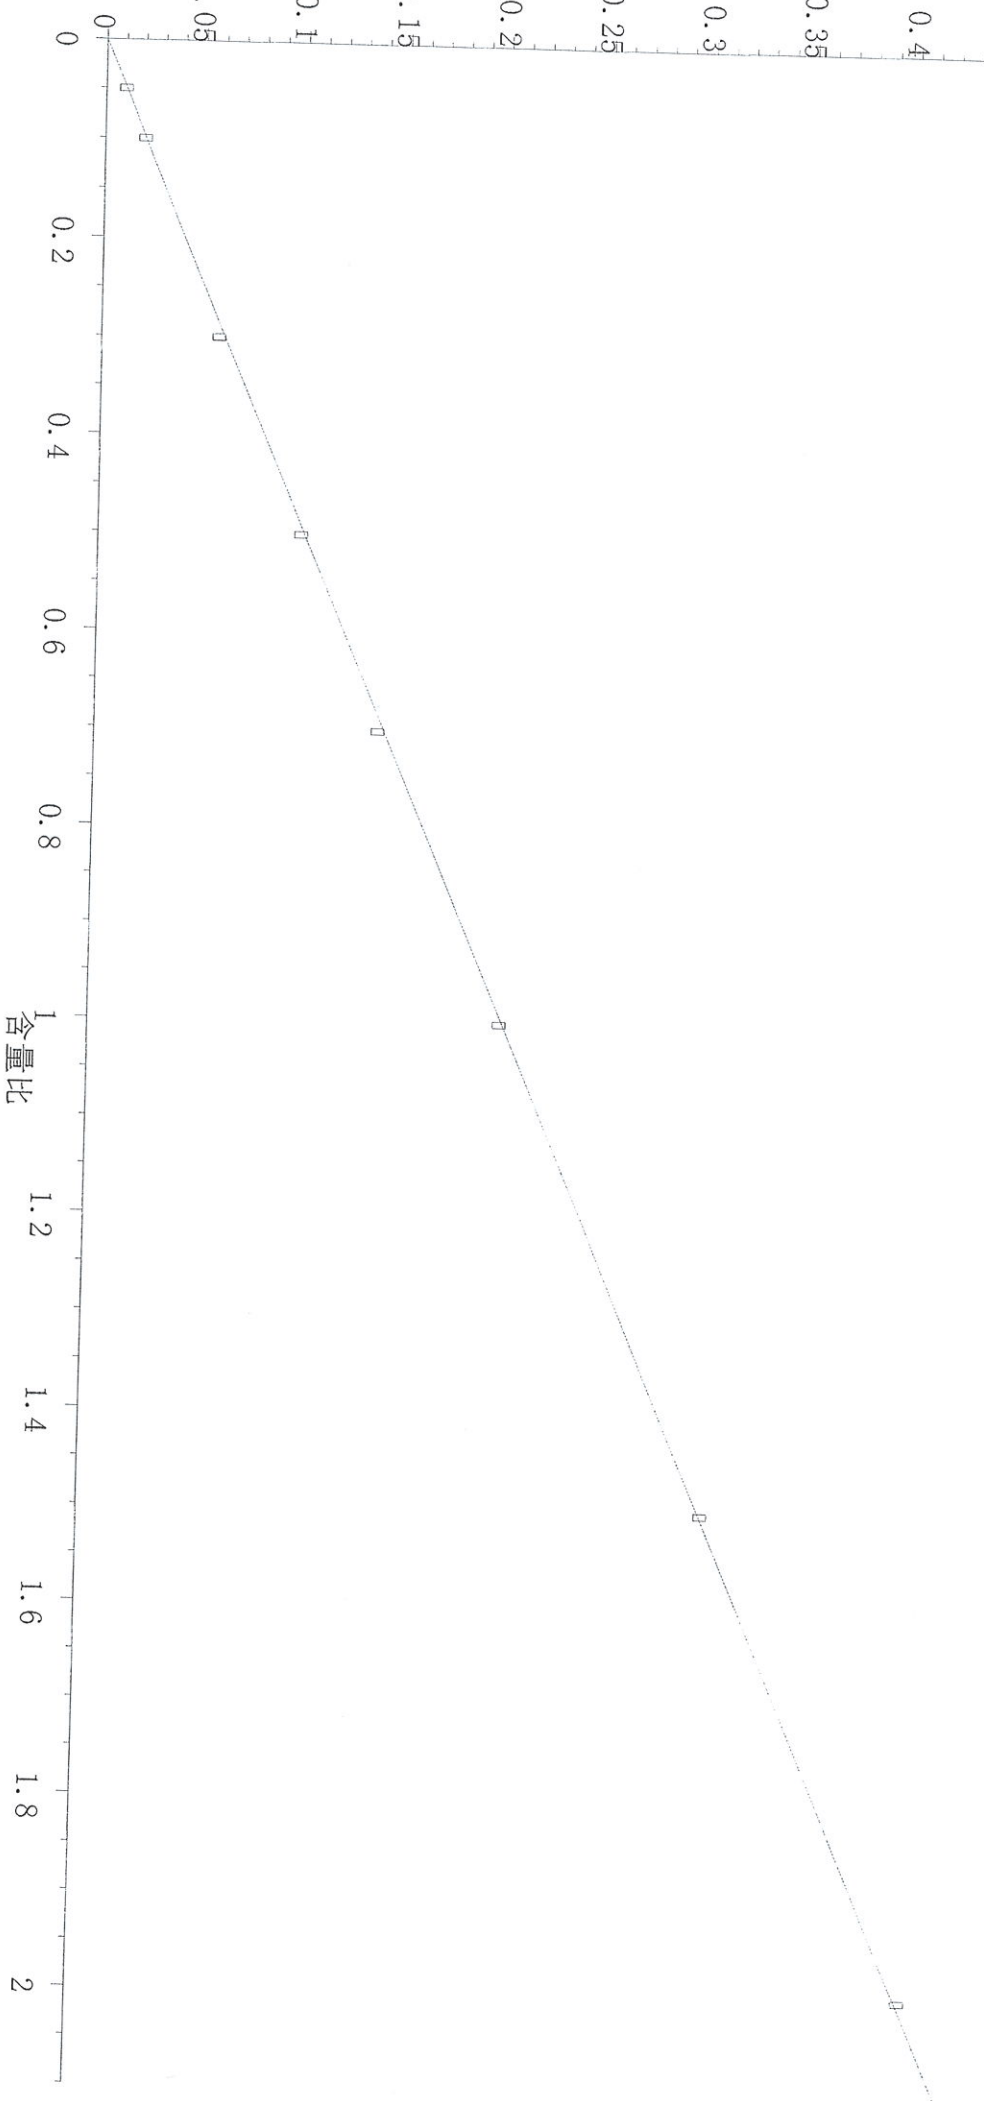

响应比 = $2.045e-001 * \text{含量比}$
相关系数 (r^2) = 0.999902
18(共18页)

线性拟合: 线性人:


校对:

审核:

校正数据 甲体-六六六

VLID	样品量 (比例)	响应 (比例)	偏差 (%)	数据文件
	0.0500	0.005957	-0.35	D:\MassHunter\2020\六六六滴涕\2020-04-配液仪器验收\50-50.D
	0.1000	0.011960	-0.22	D:\MassHunter\2020\六六六滴涕\2020-04-配液仪器验收\100-100.D
	0.3000	0.035277	-2.88	D:\MassHunter\2020\六六六滴涕\2020-04-配液仪器验收\300-300.D
	0.5000	0.060895	-0.42	D:\MassHunter\2020\六六六滴涕\2020-04-配液仪器验收\500-500.D
	0.7000	0.086249	-0.25	D:\MassHunter\2020\六六六滴涕\2020-04-配液仪器验收\700-700.D
	1.0000	0.125612	0.20	D:\MassHunter\2020\六六六滴涕\2020-04-配液仪器验收\1000-1000.D
	1.5000	0.193525	0.47	D:\MassHunter\2020\六六六滴涕\2020-04-配液仪器验收\1500-1500.D
	2.0000	0.262432	-0.19	D:\MassHunter\2020\六六六滴涕\2020-04-配液仪器验收\2000-2000.D

响应比 甲体-六六六

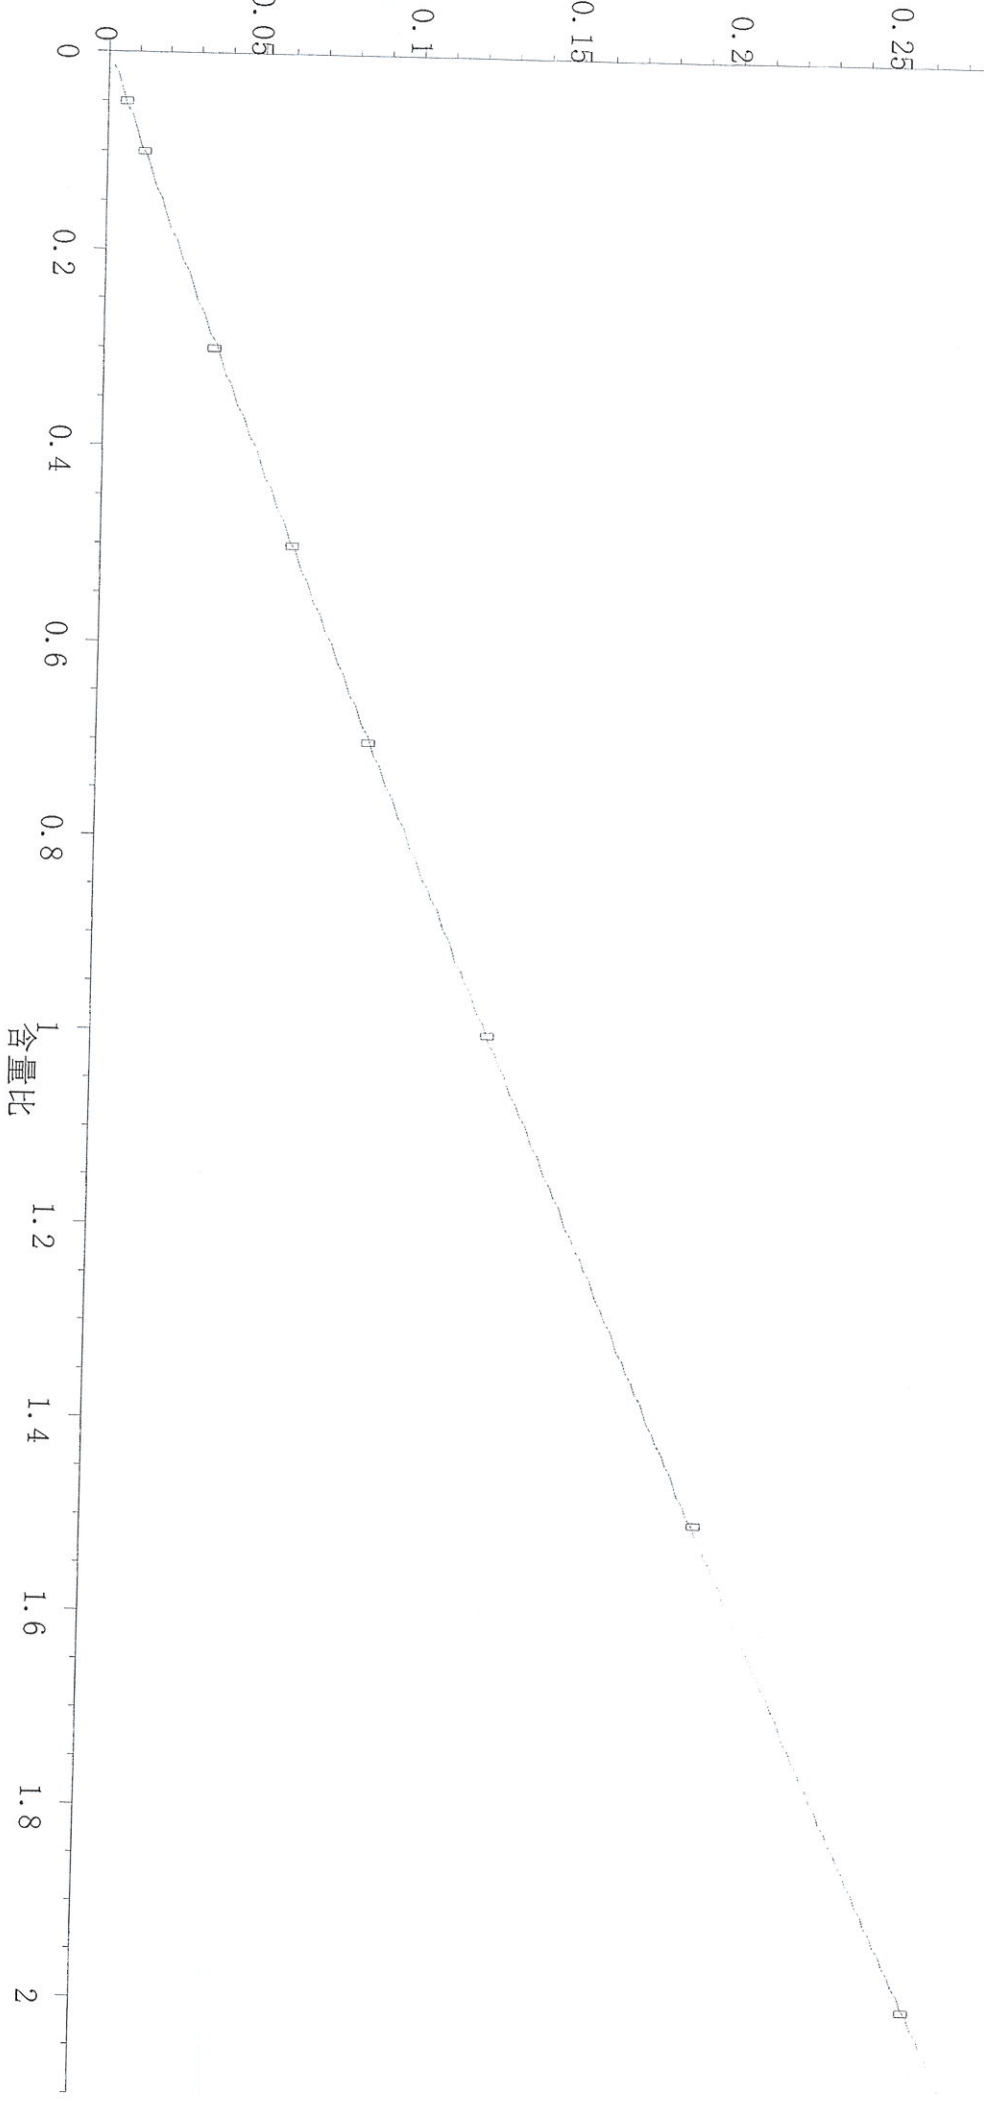


$R^2 = 6.110e-003$ $A \cdot A + 1.192e-001$ $A + 0.000e+000$
相关系数 (r^2) = 0.99964 曲线拟合: 平方/(0, 0)

校正数据 丙体-六六六


VLID	样品量 (比例)	响应 (比例)	偏差 (%)	数据文件
	0.0500	0.004875	-1.52	D:\MassHunter\2020\六六六滴涕\2020-04-配液仪器验收\50-50.D
	0.1000	0.009847	-0.87	D:\MassHunter\2020\六六六滴涕\2020-04-配液仪器验收\100-100.D
	0.3000	0.029082	-3.72	D:\MassHunter\2020\六六六滴涕\2020-04-配液仪器验收\300-300.D
	0.5000	0.050808	-0.41	D:\MassHunter\2020\六六六滴涕\2020-04-配液仪器验收\500-500.D
	0.7000	0.072091	-0.38	D:\MassHunter\2020\六六六滴涕\2020-04-配液仪器验收\700-700.D
	1.0000	0.105740	0.32	D:\MassHunter\2020\六六六滴涕\2020-04-配液仪器验收\1000-1000.D
	1.5000	0.164038	0.54	D:\MassHunter\2020\六六六滴涕\2020-04-配液仪器验收\1500-1500.D
	2.0000	0.223770	-0.23	D:\MassHunter\2020\六六六滴涕\2020-04-配液仪器验收\2000-2000.D

响应比 丙体-六六六

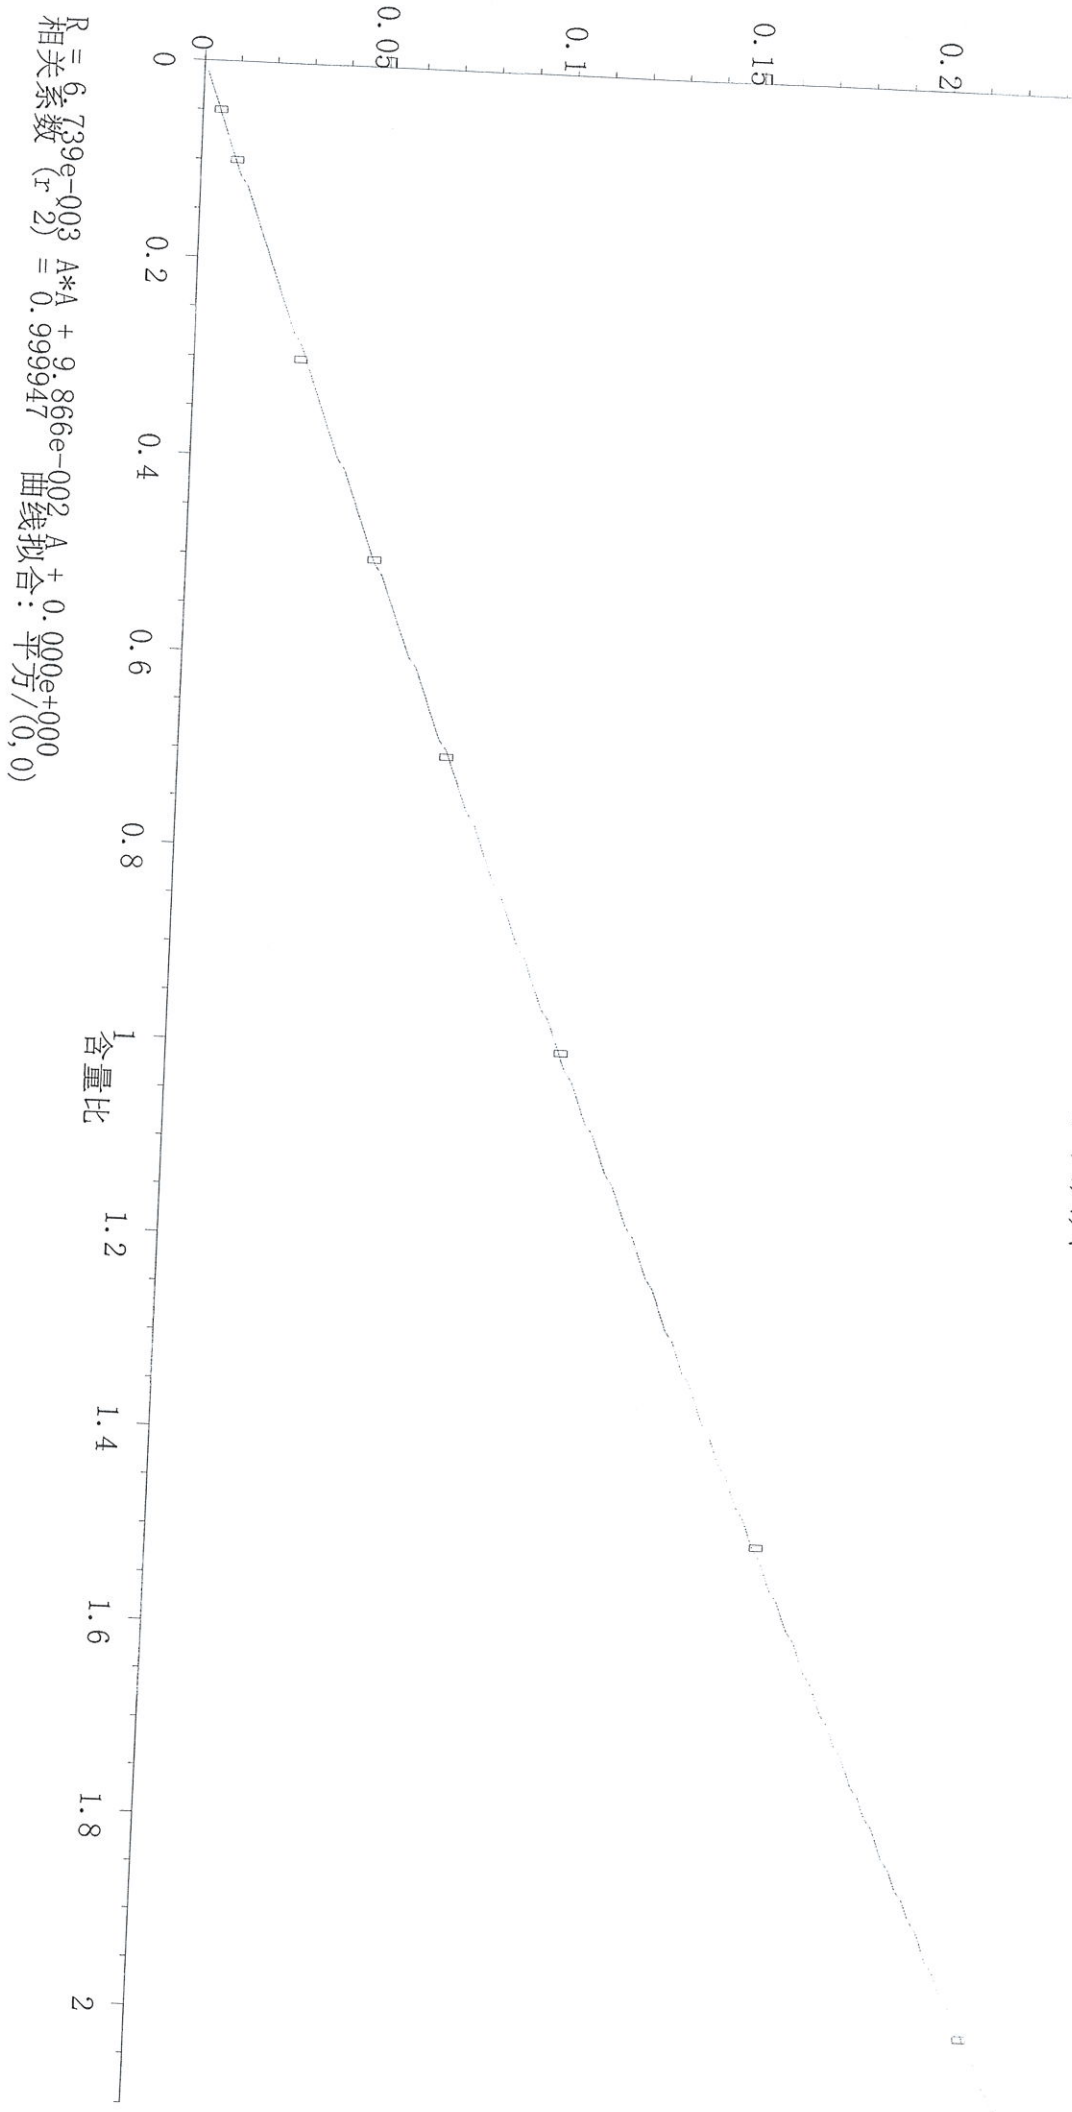

LID	样品量 (比例)	响应 (比例)	偏差 (%)	数据文件
	0.0500	0.005575	-1.58	D:\MassHunter\2020\六六六滴涕\2020-04-配液仪器验收\50-50.D
	0.1000	0.011279	-0.69	D:\MassHunter\2020\六六六滴涕\2020-04-配液仪器验收\100-100.D
	0.3000	0.033235	-3.48	D:\MassHunter\2020\六六六滴涕\2020-04-配液仪器验收\300-300.D
	0.5000	0.057757	-0.40	D:\MassHunter\2020\六六六滴涕\2020-04-配液仪器验收\500-500.D
	0.7000	0.081598	-0.52	D:\MassHunter\2020\六六六滴涕\2020-04-配液仪器验收\700-700.D
	1.0000	0.119352	0.32	D:\MassHunter\2020\六六六滴涕\2020-04-配液仪器验收\1000-1000.D
	1.5000	0.184046	0.60	D:\MassHunter\2020\六六六滴涕\2020-04-配液仪器验收\1500-1500.D
	2.0000	0.249313	-0.25	D:\MassHunter\2020\六六六滴涕\2020-04-配液仪器验收\2000-2000.D


响应比 乙体-六六六

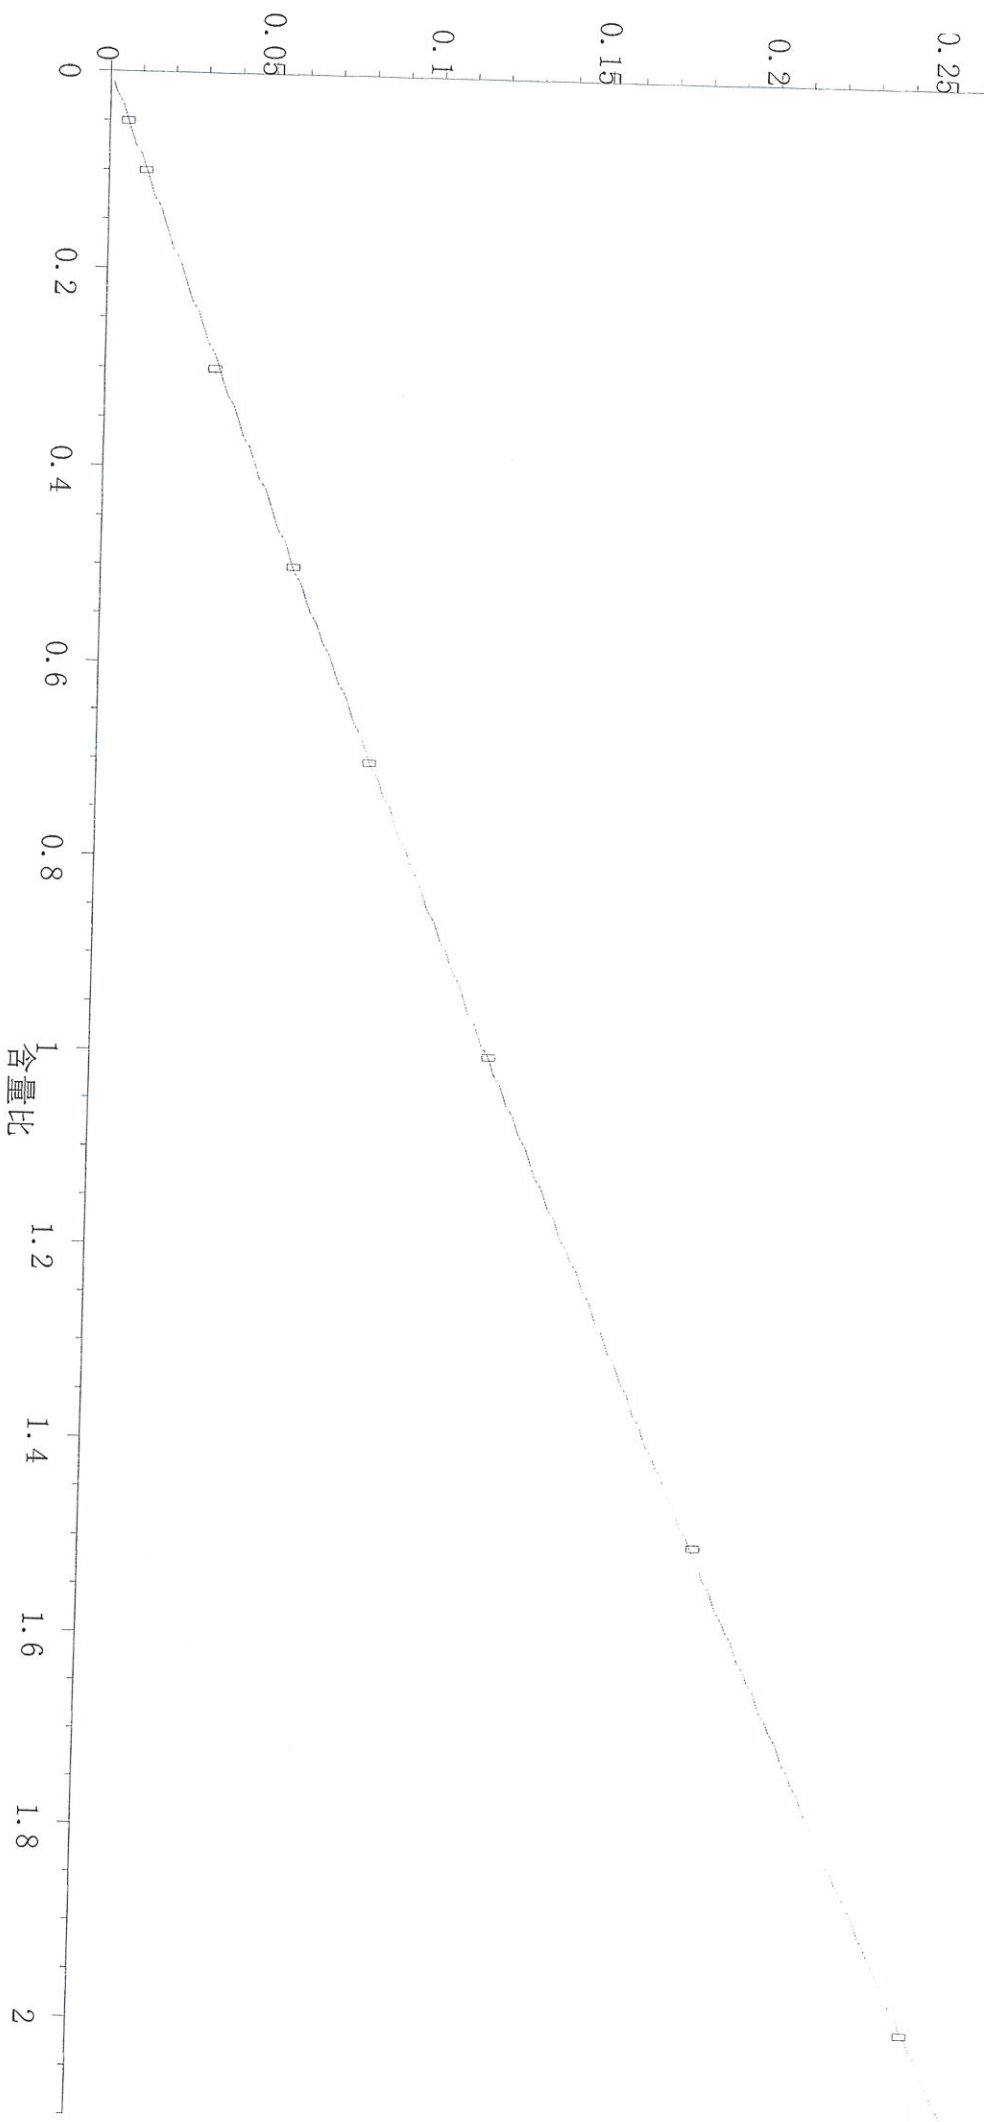

$R^2 = 0.990003$
 $A \cdot A + 1.130 \times 10^{-1} A + 0.000 \times 10^0$
相关系数 $(r^2) = 0.999943$ 曲线拟合: 平方/(0, 0)

vLID	样品量 (比例)	响应 (比例)	偏差 (%)	数据文件
0.0500	0.004881	-1.39	D:\MassHunter\2020\六六六滴涕\2020-04-配液仪器验收\50-50.D	
0.1000	0.009963	0.32	D:\MassHunter\2020\六六六滴涕\2020-04-配液仪器验收\100-100.D	
0.3000	0.029280	-2.93	D:\MassHunter\2020\六六六滴涕\2020-04-配液仪器验收\300-300.D	
0.5000	0.050632	-0.52	D:\MassHunter\2020\六六六滴涕\2020-04-配液仪器验收\500-500.D	
0.7000	0.072076	-0.06	D:\MassHunter\2020\六六六滴涕\2020-04-配液仪器验收\700-700.D	
1.0000	0.105192	-0.28	D:\MassHunter\2020\六六六滴涕\2020-04-配液仪器验收\1000-1000.D	
1.5000	0.162530	0.32	D:\MassHunter\2020\六六六滴涕\2020-04-配液仪器验收\1500-1500.D	
2.0000	0.221892	-0.15	D:\MassHunter\2020\六六六滴涕\2020-04-配液仪器验收\2000-2000.D	

丁体-六六六

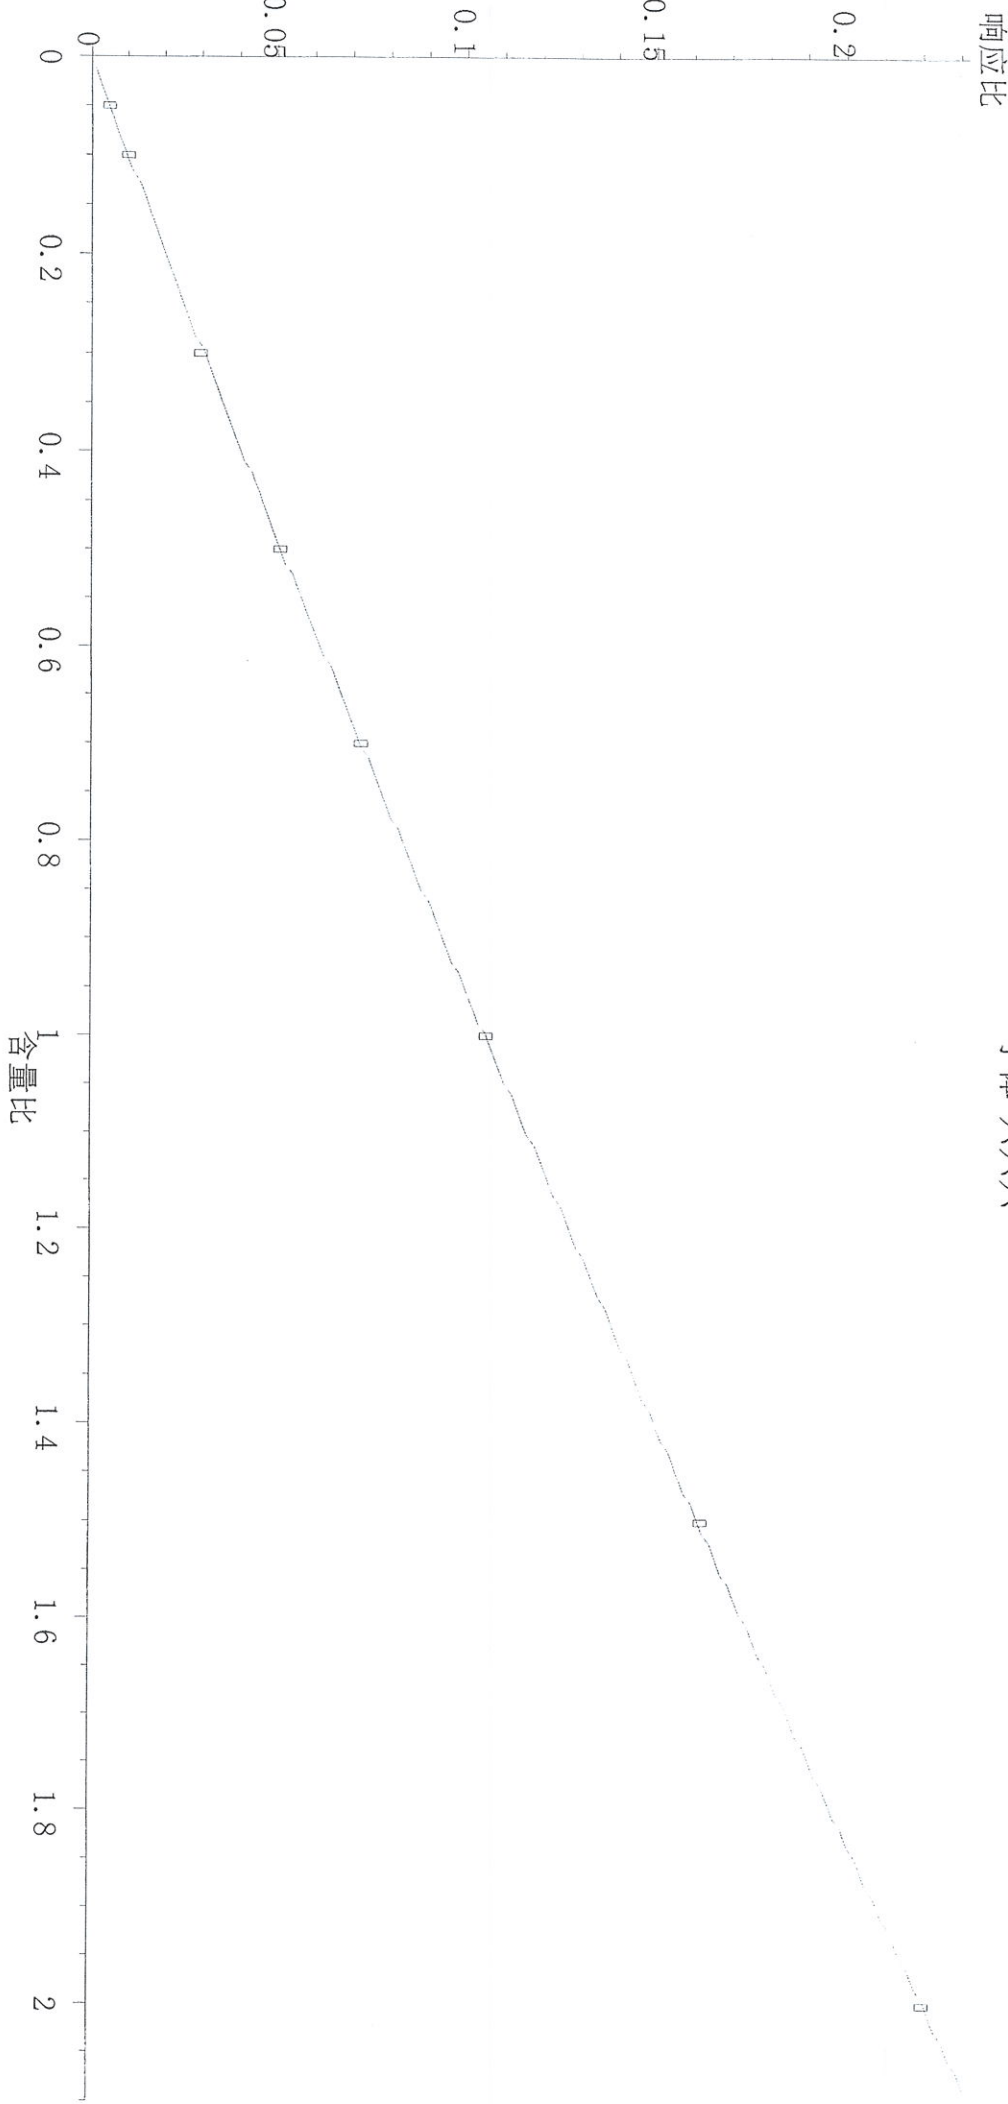


校正数据 p, p'-DDE

vLID	样品量 (比例)	响应 (比例)	偏差 (%)	数据文件
0.0500	0.012551	-4.44	D:\MassHunter\2020\六六六滴涕\2020-04-配液仪器验收\50-50.D	
0.1000	0.025999	-1.35	D:\MassHunter\2020\六六六滴涕\2020-04-配液仪器验收\100-100.D	
0.3000	0.077544	-3.21	D:\MassHunter\2020\六六六滴涕\2020-04-配液仪器验收\300-300.D	
0.5000	0.133768	-1.12	D:\MassHunter\2020\六六六滴涕\2020-04-配液仪器验收\500-500.D	
0.7000	0.190265	-0.83	D:\MassHunter\2020\六六六滴涕\2020-04-配液仪器验收\700-700.D	
1.0000	0.281116	0.64	D:\MassHunter\2020\六六六滴涕\2020-04-配液仪器验收\1000-1000.D	
1.5000	0.435167	0.69	D:\MassHunter\2020\六六六滴涕\2020-04-配液仪器验收\1500-1500.D	
2.0000	0.591985	-0.30	D:\MassHunter\2020\六六六滴涕\2020-04-配液仪器验收\2000-2000.D	

响应比

p, p'-DDE

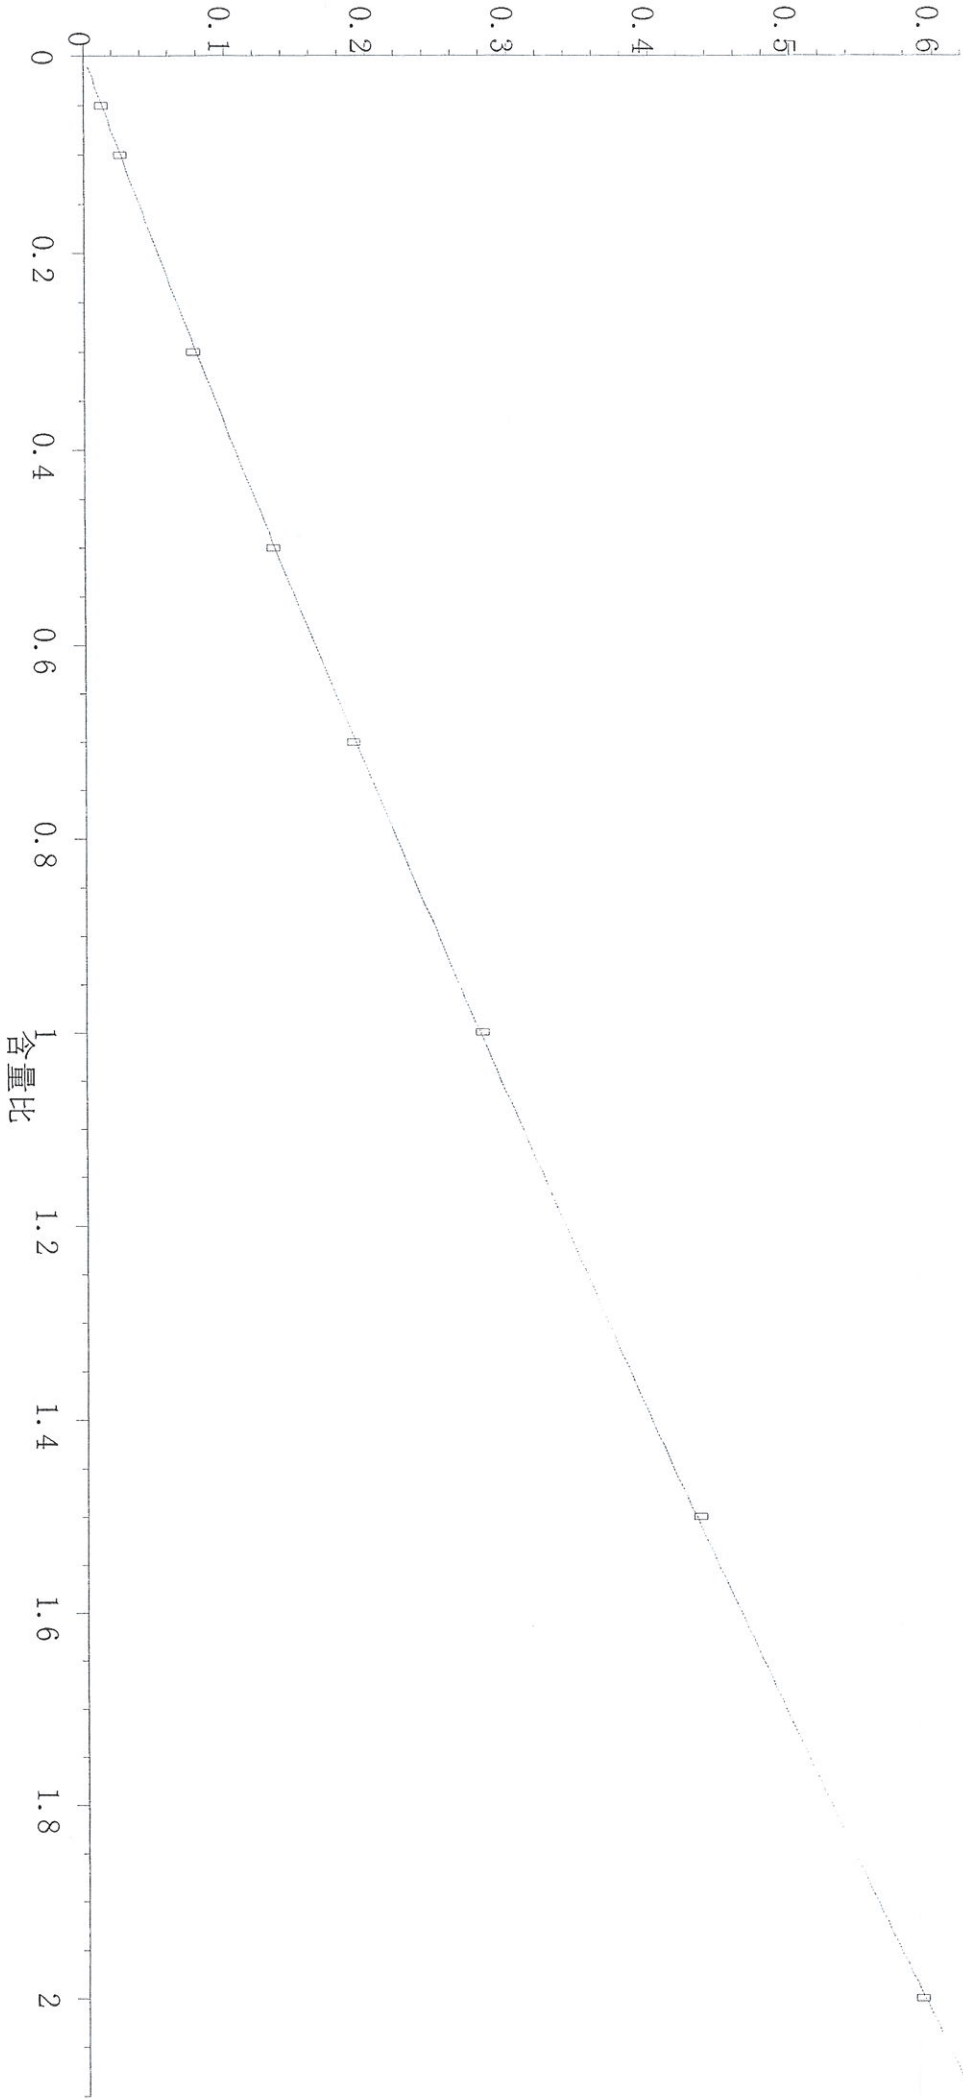


$R = 1.754e-002$
 $A * A + 2.618e-001$
 曲线拟合: 平方/(0, 0)

校正数据 p, p'-DDD

LvlID	样品量 (比例)	响应 (比例)	偏差 (%)	数据文件
1	0.0500	0.013910	-2.02	D:\MassHunter\2020\六六六滴涕\2020-04-配液仪器验收\50-50.D
2	0.1000	0.028460	-0.52	D:\MassHunter\2020\六六六滴涕\2020-04-配液仪器验收\100-100.D
3	0.3000	0.084882	-4.06	D:\MassHunter\2020\六六六滴涕\2020-04-配液仪器验收\300-300.D
4	0.5000	0.149568	-1.45	D:\MassHunter\2020\六六六滴涕\2020-04-配液仪器验收\500-500.D
5	0.7000	0.216342	-1.02	D:\MassHunter\2020\六六六滴涕\2020-04-配液仪器验收\700-700.D
6	1.0000	0.328172	0.87	D:\MassHunter\2020\六六六滴涕\2020-04-配液仪器验收\1000-1000.D
7	1.5000	0.524364	0.70	D:\MassHunter\2020\六六六滴涕\2020-04-配液仪器验收\1500-1500.D
8	2.0000	0.735597	-0.31	D:\MassHunter\2020\六六六滴涕\2020-04-配液仪器验收\2000-2000.D

响应比

p, p'-DDD

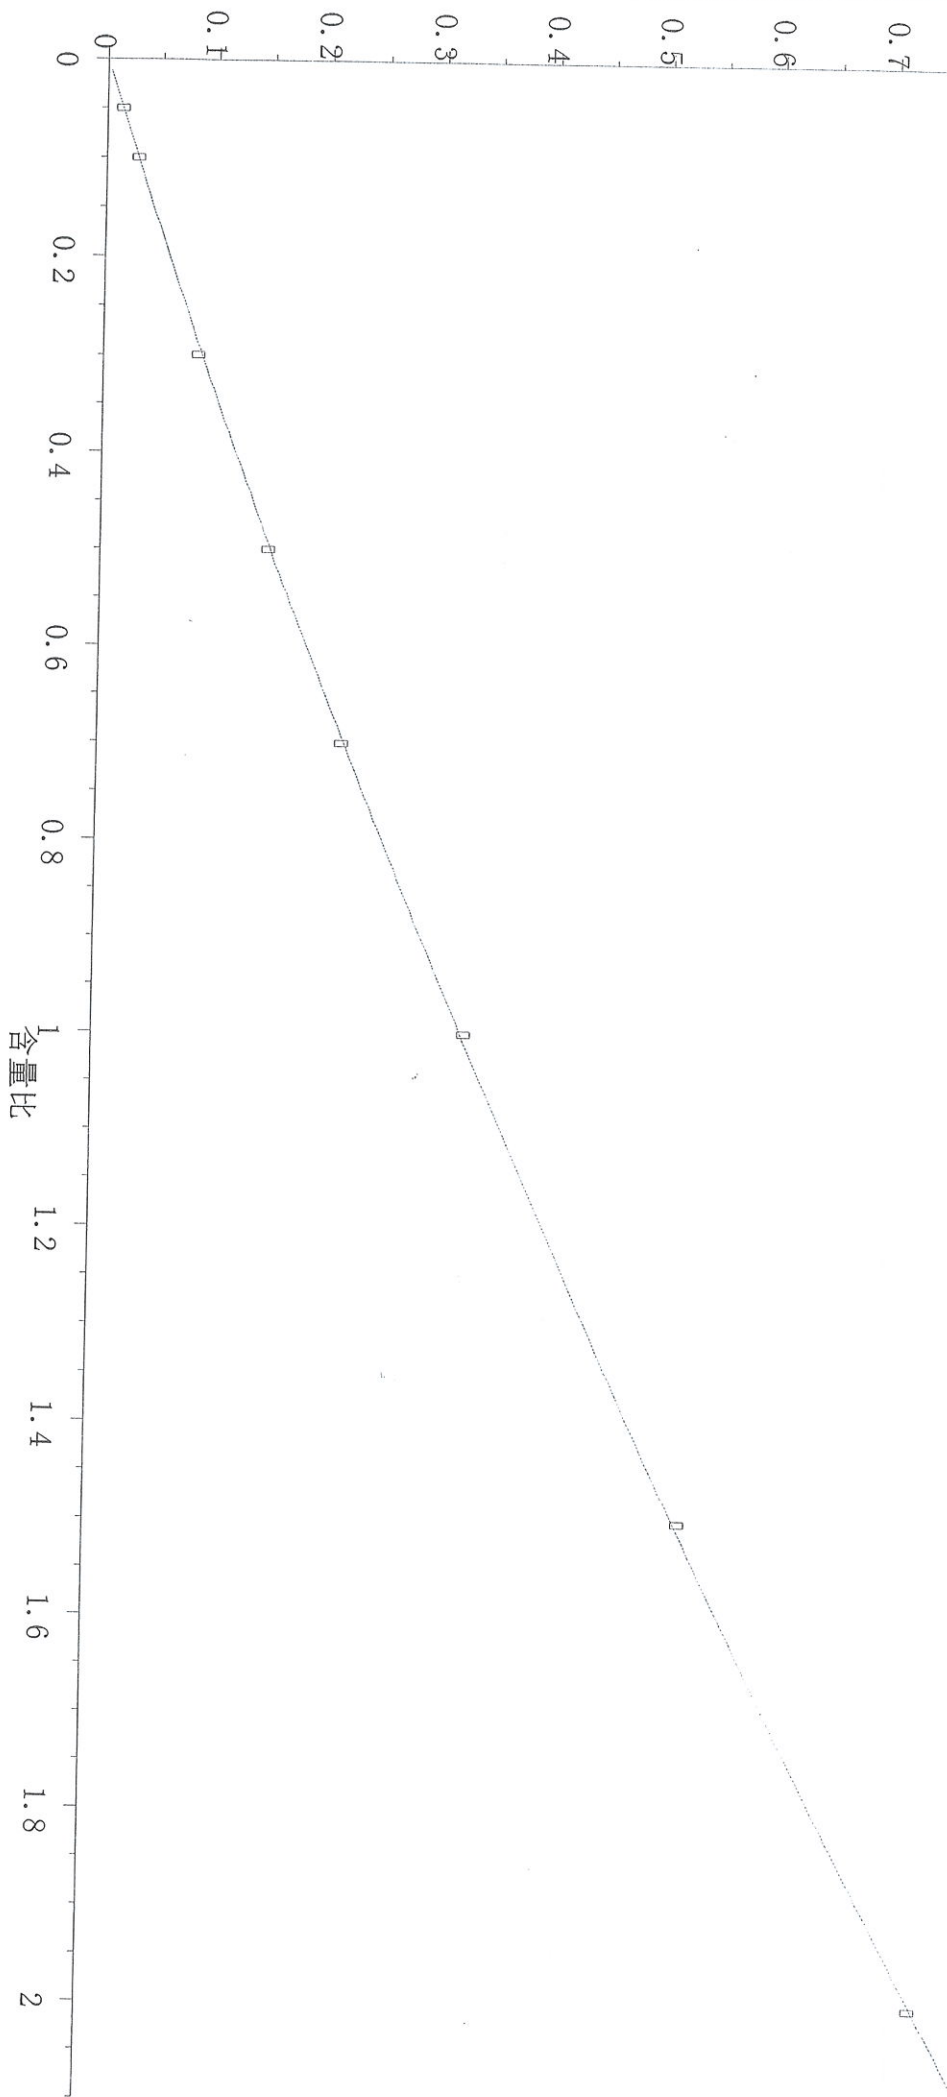

$R = 4.360e-002$ $A * A + 2.817e-001$ $A + 0.000e+000$
相关系数 $(r^2) = 0.999903$ 曲线拟合: 平方/(0, 0)